

Ballast Osram non-réglable : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 1 X 28 / 54 / 35 / 49 GII - commande 1 tube T5 54 W.
Electronic ballast Osram non-regulated : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 1 X 28 / 54 / 35 / 49 GII - drives 1 fluorescent lamp T5 54 W.
 Elektronisches Vorschaltgerät Osram nicht regelbar/einstellbar: QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 1 X 28 / 54 / 35 / 49 GII - betätigt 1 Röhre T5 54 W

Destiné aux luminaires degré K - *Intended for degré K medical lights* - Bestimmt für die degré K Leuchten:

- **albédo 5.H** **!! Attention!! uniquement pour les tubes du dessus !!** **(!! Attention!! For the upper fluorescent lamps only!!)** **(!! Achtung!! ausschließlich für die Oberröhren)**
- **albédo 5.0** **!! Attention!! uniquement pour un tube du milieu !!** **(!! Attention!! For one middle fluorescent lamp only!!)** **(!! Achtung!! ausschließlich für eine Mittelröhre)**

!! Important !! !! Sehr wichtig !!

Les fabricants de ballasts (Osram et Philips) ont modifié les dimensions et/ou caractéristiques techniques de leurs appareils. Nous avons donc été amenés à nous adapter et à modifier nos luminaires.
 Les luminaires équipés avec les anciennes versions de ballasts qui nécessitent des interventions de changement de ballast ne pourront être équipés qu'avec les nouvelles versions, ce qui implique un changement dans les connexions électriques.
 Nous avons donc préparé un document décrivant la mutation d'un ballast à un autre.
 Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant luminaire par luminaire les modifications ayant pu intervenir et la modification des schémas de câblage qui en découle qu'il convient de strictement respecter.

The producers of electrical ballasts (Osram & Philips) have changed the size and/or technical characteristics of their devices. Thus we have to adapt and make some changes in our medical lights.

The lights equipped with old versions of ballasts that require interventions now can be equipped only with new versions whose electrical connection is different. We have prepared the document describing the shift from the old electrical ballast to the new one.

You will find below a table presenting light by light replacement of the ballast and as a result changes in the wiring diagrams, which you are strictly advised to follow.

Die Vorschaltgerätehersteller (Osram und Philips) haben die Dimensionen geändert und/oder technische Daten einiger Ihrer Geräte. Dies verursacht ein Anpassen und ein Verändern unserer Leuchten.

Die Leuchten die mit alten elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet sind und ein Vorschaltgerät-Austausch bedürfen können ausschließlich mit den neuen Vorschaltgeräten ausgerüstet werden.





Dies hat als Schlussfolgerung eine Änderung der elektrischen Anschlüsse.

Wir haben aus diesem Grund eine Unterlage vorbereitet, die den Übergang vom alten zum neuen Vorschaltgerät erklärt

Weiter unten finden Sie eine Tabelle, die jede Leuchte mit den entsprechenden Änderungen beschreibt und die daraus entstandene Änderung des Kabelschemas, wobei die bitte strengstens zu beachten ist.



EVOLUTION DES SCHEMAS DE CABLAGE / WIRING DIAGRAMS TRANSITION / VERÄNDERUNG DES KABELANSCHLUßSCHEMAS

Nom du lum. The light name Leuchten-bezeichnung	Qté de ce ballast par lum. Number of this EB per light Anzahl dieses VG pro Leuchte	A Schéma de l'ancien ballast Diagram of the old EB Schema des alten VG	B Schéma du nouveau Ballast : BAL_154 Diagram of the new EB / Schema des neuen VG QT1 1 x 28 / 54 / 35 / 49 GII	Branchement A vers B Connection from A to B Anschluß A nach B
ALBEDO 5.H	2 (1 ballast par tube) (1 ballast per lamp) (1 VG pro Röhre)	 <p>EVG154PH.02 - 928 610 30</p> <p>HF-PERFORMER HF-P 154 TL5 HO EII 220-240</p>	 <p>QT1 1x... GII</p>	1-23 2-24 3-21 4-22
ALBEDO 5.0	1	 <p>EVG154PH.02 - 928 610 30</p> <p>HF-PERFORMER HF-P 154 TL5 HO EII 220-240</p>	 <p>QT1 1x... GII</p>	1-23 2-24 3-21 4-22

Ballast Osram réglable : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 1 X 28 / 54 DIM - commande 1 tube T5 54 W.
Electronic ballast Osram regulated : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 1 X 28 / 54 DIM - drives 1 fluorescent lamp T5 54 W.
Elektronisches Vorschaltgerät Osram regelbar: QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 1 X 28 / 54 DIM - betätigt 1 Röhre T5 54 W

Destiné au luminaire degré K - Intended for degré K medical light - Bestimmt für die degré K Leuchte:

- albedo 5.R **(!! Attention!! uniquement pour un tube du milieu !!) (!! Attention!! For a middle fluorescent lamp only!!) (!! Achtung!! ausschließlich für eine Mittelröhre)**

!! Important !! !! Sehr wichtig !!

Les fabricants de ballasts (Osram et Philips) ont modifié les dimensions et/ou caractéristiques techniques de leurs appareils. Nous avons donc été amenés à nous adapter et à modifier nos luminaires.

Les luminaires équipés avec les anciennes versions de ballasts qui nécessitent des interventions de changement de ballast ne pourront être équipés qu'avec les nouvelles versions, ce qui implique un changement dans les connexions électriques.

Nous avons donc préparé un document décrivant la mutation d'un ballast à un autre.

Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant luminaire par luminaire les modifications ayant pu intervenir et la modification des schémas de câblage qui en découle qu'il convient de strictement respecter.

The producers of electrical ballasts (Osram & Philips) have changed the size and/or technical characteristics of their devices. Thus we have to adapt and make some changes in our medical lights.

The lights equipped with old versions of ballasts that require interventions now can be equipped only with new versions whose electrical connection is different. We have prepared the document describing the shift from the old electrical ballast to the new one.

You will find below a table presenting light by light replacement of the ballast and as a result changes in the wiring diagrams, which you are strictly advised to follow.

Die Vorschaltgerätehersteller (Osram und Philips) haben die Dimensionen geändert und/oder technische Daten einiger Ihrer Geräte. Dies verursacht ein Anpassen und ein Verändern unserer Leuchten.

Die Leuchten die mit alten elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet sind und ein Vorschaltgerät-Austausch bedürfen können ausschließlich mit den neuen Vorschaltgeräten ausgerüstet werden.

Dies hat als Schlussfolgerung eine Änderung der elektrischen Anschlüsse.

Wir haben aus diesem Grund eine Unterlage vorbereitet, die den Übergang vom alten zum neuen Vorschaltgerät erklärt

Weiter unten finden Sie eine Tabelle, die jede Leuchte mit den entsprechenden Änderungen beschreibt und die daraus entstandene Änderung des Kabelschemas, wobei die bitte strengstens zu beachten ist.



EVOLUTION DES SCHEMAS DE CABLAGE / WIRING DIAGRAMS TRANSITION / VERÄNDERUNG DES KABELANSCHLUßSCHEMAS

Nom du lum. The light name Leuchten-bezeichnung	Qté de ce ballast par lum. Number of this EB per light Anzahl dieses VG pro Leuchte	A Schéma de l'ancien ballast Diagram of the old EB Schema des alten VG	B Schéma du nouveau Ballast : BAL_154_R Diagram of the new EB / Schema des neuen VG QT1 1 x 28 / 54 DIM	Branchement A vers B Connection from A to B Anschluß A nach B
ALBEDO 5.R	1	<p>EVG154PH.AR01 - 060 549 30</p> <p>HF-REGULATOR HF-R 154 T15 EII 220-240</p>	<p>EVG128OS.AR1M - 4050300870588</p>	<p>1-26 2-27 3-21 4-22</p>

Ballast Osram réglable : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 2 X 14/24/21/39 - commande 2 tubes T5 24 W.
Electronic ballast Osram regulated : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 2 X 14/24/21/39 - drives 2 fluorescent lamps T5 24 W.
Elektronisches Vorschaltgerät Osram regelbar: QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 2 X 14/24/21/39 - betätigt 2 Röhren T5 24 W

Destiné aux luminaires degré K - Intended for degré K medical lights - Bestimmt für die degré K Leuchten:

- albémi
- Iola 2.0 Solo

!! Important !! !! Sehr wichtig !!

Les fabricants de ballasts (Osram et Philips) ont modifié les dimensions et/ou caractéristiques techniques de leurs appareils. Nous avons donc été amenés à nous adapter et à modifier nos luminaires.

Les luminaires équipés avec les anciennes versions de ballasts qui nécessitent des interventions de changement de ballast ne pourront être équipés qu'avec les nouvelles versions, ce qui implique un changement dans les connexions électriques.

Nous avons donc préparé un document décrivant la mutation d'un ballast à un autre.

Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant luminaire par luminaire les modifications ayant pu intervenir et la modification des schémas de câblage qui en découle qu'il convient de strictement respecter.

The producers of electrical ballasts (Osram & Philips) have changed the size and/or technical characteristics of their devices. Thus we have to adapt and make some changes in our medical lights.

The lights equipped with old versions of ballasts that require interventions now can be equipped only with new versions whose electrical connection is different.

We have prepared the document describing the shift from the old electrical ballast to the new one.

You will find below a table presenting light by light replacement of the ballast and as a result changes in the wiring diagrams, which you are strictly advised to follow.

Die Vorschaltgerätehersteller (Osram und Philips) haben die Dimensionen geändert und/oder technische Daten einiger Ihrer Geräte. Dies verursacht ein Anpassen und ein Verändern unserer Leuchten.

Die Leuchten die mit alten elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet sind und ein Vorschaltgerät-Austausch bedürfen können ausschließlich mit den neuen Vorschaltgeräten ausgerüstet werden.



Dies hat als Schlussfolgerung eine Änderung der elektrischen Anschlüssen.

Wir haben aus diesem Grund eine Unterlage vorbereitet, die den Übergang vom alten zum neuen Vorschaltgerät erklärt

Weiter unten finden Sie eine Tabelle, die jede Leuchte mit den entsprechenden Änderungen beschreibt und die daraus entstandene Änderung des Kabelschemas, wobei die bitte strengstens zu beachten ist.



EVOLUTION DES SCHEMAS DE CABLAGE / WIRING DIAGRAMS TRANSITION / VERÄNDERUNG DES KABELANSCHLUßSCHEMAS

Nom du lum. The light name Leuchten-bezeichnung	Qté de ce ballast par lum. Number of this EB per light Anzahl dieses VG pro Leuchte	A Schéma de l'ancien ballast Diagram of the old EB Schema des alten VG	B Schéma du nouveau Ballast : BAL_224 Diagram of the new EB / Schema des neuen VG QT1 2 X 14 / 24 / 21 / 39	Branchement A vers B Connection from A to B Anschluß A nach B
albémi Iola 2.0 Solo	1	 <p>HF-PERFORMER HF-P 224 TL5 EII 220-240</p>	 <p>EVG2280S.04M - 4050300797076</p>	<p>1-27 2-26 3-23 4-22 5-25 6-24</p>

Ballast Osram réglable : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2 X 36 / 220-240 DIM - commande 2 tubes PLL 36 W.
 Electronic ballast Osram regulated : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2 X 36 / 220-240 DIM - drives 2 fluorescent lamps PLL 36 W.
 Elektronisches Vorschaltgerät Osram regelbar: QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2 X 36 / 220-240 DIM - betätigt 2 Röhren PLL 36 W

Destiné aux luminaires degré K - *Intended for degré K medical lights* - Bestimmt für die degré K Leuchten:
 - albedo 4.R

!! Important !! !! Sehr wichtig !!

Les fabricants de ballasts (Osram et Philips) ont modifié les dimensions et/ou caractéristiques techniques de leurs appareils. Nous avons donc été amenés à nous adapter et à modifier nos luminaires.

Les luminaires équipés avec les anciennes versions de ballasts qui nécessitent des interventions de changement de ballast ne pourront être équipés qu'avec les nouvelles versions, ce qui implique un changement dans les connexions électriques.

Nous avons donc préparé un document décrivant la mutation d'un ballast à un autre.

Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant luminaire par luminaire les modifications ayant pu intervenir et la modification des schémas de câblage qui en découle qu'il convient de strictement respecter.

The producers of electrical ballasts (Osram & Philips) have changed the size and/or technical characteristics of their devices. Thus we have to adapt and make some changes in our medical lights.

The lights equipped with old versions of ballasts that require interventions now can be equipped only with new versions whose electrical connection is different.

We have prepared the document describing the shift from the old electrical ballast to the new one.

You will find below a table presenting light by light replacement of the ballast and as a result changes in the wiring diagrams, which you are strictly advised to follow.

Die Vorschaltgerätehersteller (Osram und Philips) haben die Dimensionen geändert und/oder technische Daten einiger Ihrer Geräte. Dies verursacht ein Anpassen und ein Verändern unserer Leuchten.

Die Leuchten die mit alten elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet sind und ein Vorschaltgerät-Austausch bedürfen können ausschließlich mit den neuen Vorschaltgeräten ausgerüstet werden.

Dies hat als Schlussfolgerung eine Änderung der elektrischen Anschlüssen.

Wir haben aus diesem Grund eine Unterlage vorbereitet, die den Übergang vom alten zum neuen Vorschaltgerät erklärt



EVOLUTION DES SCHEMAS DE CABLAGE / WIRING DIAGRAMS TRANSITION / VERÄNDERUNG DES KABELANSCHLUßSCHEMAS

Nom du lum. The light name Leuchten- bezeichnung	Qte de ce ballast par lum. Number of this EB per light Anzahl dieses VG pro Leuchte	A Schéma de l'ancien ballast <i>Diagram of the old EB</i> Schema des alten VG	B Schéma du nouveau Ballast : BAL_236_R <i>Diagram of the new EB / Schema des neuen VG</i> ⤵ QT i 2 x 36 / 220-240 DIM	Branchement Connection Anschluß A => B
ALBEDO 4.R	2			1-27 2-26 3-23 4-21 5-22 6-24 7-25

Ballast Osram non-réglable : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 2 X 28 / 54 / 35 / 49 GII - commande 2 tubes T5 54 W.
Electronic ballast Osram non-regulated : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 2 X 28 / 54 / 35 / 49 GII - drives 2 fluorescent lamps T5 54 W.
Elektronisches Vorschaltgerät Osram nicht regelbar/einstellbar: QUICKTRONIC INTELLIGENT QT1 2 X 28 / 54 / 35 / 49 GII - betätigt 2 Röhren T5 54 W

Destiné aux luminaires degré K - Intended for degré K medical lights - Bestimmt für die degré K Leuchten:

- win'jie 2.0 - albédino 1.0 - candélio 1.0 - albédo N8 - lola 2.0 duo
- albédo 5.0 **(!! Attention!! uniquement pour les tubes latéraux !!) (!! Attention!! For lateral fluorescent lamps only!!) (!! Achtung!! ausschließlich für die Randröhren)**

!! Important !! !! Sehr wichtig !!

Les fabricants de ballasts (Osram et Philips) ont modifié les dimensions et/ou caractéristiques techniques de leurs appareils. Nous avons donc été amenés à nous adapter et à modifier nos luminaires.

Les luminaires équipés avec les anciennes versions de ballasts qui nécessitent des interventions de changement de ballast ne pourront être équipés qu'avec les nouvelles versions, ce qui implique un changement dans les connexions électriques.

Nous avons donc préparé un document décrivant la mutation d'un ballast à un autre.

Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant luminaire par luminaire les modifications ayant pu intervenir et la modification des schémas de câblage qui en découle qu'il convient de strictement respecter.

The producers of electrical ballasts (Osram & Philips) have changed the size and/or technical characteristics of their devices. Thus we have to adapt and make some changes in our medical lights.

The lights equipped with old versions of ballasts that require interventions now can be equipped only with new versions whose electrical connection is different.

We have prepared the document describing the shift from the old electrical ballast to the new one.

You will find below a table presenting light by light replacement of the ballast and as a result changes in the wiring diagrams, which you are strictly advised to follow.

Die Vorschaltgerätehersteller (Osram und Philips) haben die Dimensionen geändert und/oder technische Daten einiger Ihrer Geräte. Dies verursacht ein Anpassen und ein Verändern unserer Leuchten.

Die Leuchten die mit alten elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet sind und ein Vorschaltgerät-Austausch bedürfen können ausschließlich mit den neuen Vorschaltgeräten ausgerüstet werden.

Dies hat als Schlussfolgerung eine Änderung der elektrischen Anschlüsse.

Wir haben aus diesem Grund eine Unterlage vorbereitet, die den Übergang vom alten zum neuen Vorschaltgerät erklärt

Weiter unten finden Sie eine Tabelle, die jede Leuchte mit den entsprechenden Änderungen beschreibt und die daraus entstandene Änderung des Kabelschemas, wobei die bitte strengstens zu beachten ist.



EVOLUTION DES SCHEMAS DE CABLAGE / WIRING DIAGRAMS TRANSITION / VERÄNDERUNG DES KABELANSCHLUßSCHEMAS

Nom du lum. The light name Leuchten-bezeichnung	Qté de ce ballast par lum. Number of this EB per light Anzahl dieses VG pro Leuchte	A Schéma de l'ancien ballast Diagram of the old EB Schema des alten VG	B Schéma du nouveau Ballast : BAL_254 Diagram of the new EB / Schema des neuen VG QTi 2 x 28 / 54 / 35 / 49 GII	Branchement A vers B Connection from A to B Anschluß A nach B
WIN'JIE 2.0	2	 EVG254OS.01 - 4050300825410 QT-FQ 2X54/230-240	 QTi 2x... GII	1-27 2-26 3-23 4-22 5-25 6-24 Mettre un fil supplémentaire entre la borne 21 et les douilles reliées entre elles A complementary wire must be placed between the clamp 21 and the lampholders connected to each other. Ein zusätzliches Draht soll zwischen die Klemme und die beiden Lampherhalter, verknüpft zwischen einander, gezogen werden.
ALBEDO 5.0	2	 EVG254PH.03 - 910 295 30 EVG254PH.02 - 925 610 30 HF-PERFORMER HF-P 254 TL5 HO EII 54 W	 QTi 2x... GII	1-27 2-26 3-23 5-22 6-24 7-25 Mettre un fil supplémentaire entre la borne 21 et les douilles reliées entre elles A complementary wire must be placed between the clamp 21 and the lampholders connected to each other. Ein zusätzliches Draht soll zwischen die Klemme und die beiden Lampherhalter, verknüpft zwischen einander, gezogen werden.
ALBEDINO 1.0	2	 EVG254PH.03 - 910 295 30 EVG254PH.02 - 925 610 30 HF-PERFORMER HF-P 254 TL5 HO	 QTi 2x... GII	1-27 2-26 3-23 5-22 6-24 7-25 Mettre un fil supplémentaire entre la borne 21 et les douilles reliées entre elles A complementary wire must be placed between the clamp 21 and the lampholders connected to each other. Ein zusätzliches Draht soll zwischen die Klemme und die beiden Lampherhalter, verknüpft zwischen einander, gezogen werden.
CANDELIO 1.0	2	 EVG254PH.03 - 910 295 30 EVG254PH.02 - 925 610 30 HF-PERFORMER HF-P 254 TL5 HO EII 54 W	 QTi 2x... GII	1-27 2-26 3-23 5-22 6-24 7-25 Mettre un fil supplémentaire entre la borne 21 et les douilles qui sont reliées entre elles A complementary wire must be placed between the clamp 21 and the lampholders connected to each other. Ein zusätzliches Draht soll zwischen die Klemme und die beiden Lampherhalter, verknüpft zwischen einander, gezogen werden.
ALBEDO N8	2		 QTi 2x... GII	NS

Ballast Osram réglable : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT_i 2 X 28 / 54 DIM - commande 2 tubes T5 54 W.
Electronic ballast Osram regulated : QUICKTRONIC INTELLIGENT QT_i 2 X 28 / 54 DIM - drives 2 fluorescent lamps T5 54 W.
 Elektronisches Vorschaltgerät Osram regelbar: QUICKTRONIC INTELLIGENT QT_i 2 X 28 / 54 DIM - betätigt 2 Röhren T5 54 W

Destiné aux luminaires degré K - *Intended for degré K medical lights* - Bestimmt für die degré K Leuchten:

- **albédo 5.R** **(!! Attention!! uniquement pour les tubes latéraux)** *(!! Attention !! For lateral fluorescent lamps only) (!! Achtung !! ausschließlich für die Randröhren)*
- **albédo 5.H** **(!! Attention!! uniquement pour les tubes du bas)** *(!! Attention !! For lower fluorescent lamps only) (!! Achtung !! ausschließlich für die Unterröhren)*

!! Important !! !! Sehr wichtig !!

Les fabricants de ballasts (Osram et Philips) ont modifié les dimensions et/ou caractéristiques techniques de leurs appareils. Nous avons donc été amenés à nous adapter et à modifier nos luminaires.

Les luminaires équipés avec les anciennes versions de ballasts qui nécessitent des interventions de changement de ballast ne pourront être équipés qu'avec les nouvelles versions, ce qui implique un changement dans les connexions électriques.

Nous avons donc préparé un document décrivant la mutation d'un ballast à un autre.

Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant luminaire par luminaire les modifications ayant pu intervenir et la modification des schémas de câblage qui en découle qu'il convient de strictement respecter.

The producers of electrical ballasts (Osram & Philips) have changed the size and/or technical characteristics of their devices. Thus we have to adapt and make some changes in our medical lights.

The lights equipped with old versions of ballasts that require interventions now can be equipped only with new versions whose electrical connection is different. We have prepared the document describing the shift from the old electrical ballast to the new one.

You will find below a table presenting light by light replacement of the ballast and as a result changes in the wiring diagrams, which you are strictly advised to follow.

Die Vorschaltgerätehersteller (Osram und Philips) haben die Dimensionen geändert und/oder technische Daten einiger Ihrer Geräte. Dies verursacht ein Anpassen und ein Verändern unserer Leuchten.

Die Leuchten die mit alten elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet sind und ein Vorschaltgerät-Austausch bedürfen können ausschließlich mit den neuen Vorschaltgeräten ausgerüstet werden.





Dies hat als Schlussfolgerung eine Änderung der elektrischen Anschlüsse.

Wir haben aus diesem Grund eine Unterlage vorbereitet, die den Übergang vom alten zum neuen Vorschaltgerät erklärt

Weiter unten finden Sie eine Tabelle, die jede Leuchte mit den entsprechenden Änderungen beschreibt und die daraus entstandene Änderung des Kabelschemas, wobei die bitte strengstens zu beachten ist.



EVOLUTION DES SCHEMAS DE CABLAGE / WIRING DIAGRAMS TRANSITION / VERÄNDERUNG DES KABELANSCHLUßSCHEMAS

Nom du lum. The light name Leuchten-bezeichnung	Qté de ce ballast par lum. Number of this EB per light Anzahl dieses VG pro Leuchte	A Schéma de l'ancien ballast <i>Diagram of the old EB</i> Schema des alten VG	B Schéma du nouveau Ballast : BAL_254_R <i>Diagram of the new EB / Schema des neuen VG</i> ⤴ QT_i 2 x 28 / 54 DIM	Branchement A vers B <i>Connection from A to B</i> Anschluß A nach B
ALBEDO 5.R	2	 <p>HF-REGULATOR HF-R 254 TL5 EII 220-240</p>	 <p>EVG228OS.AR2M - 4050300870717</p>	1-27 2-26 3-23 4-21 5-22 6-24 7-25
ALBEDO 5.H	2	 <p>HF-REGULATOR HF-R 254 TL5 EII 220-240</p>	 <p>EVG228OS.AR2M - 4050300870717</p>	1-27 2-26 3-23 4-21 5-22 6-24 7-25

degré K

www.degrek.com

Réf. : BAL_254_R2

Ballast Philips réglable : HF-R 254 TL5 EII 220-240 - commande 2 tubes T5 54 W.

Electronic ballast Philips regulated : HF-R 254 TL5 EII 220-240 - drives 2 fluorescent lamps T5 54 W.



Elektronisches Vorschaltgerät Philips regelbar: HF-R 254 TL5 EII 220-240 - betätigt 2 Röhren T5 54 W

Destiné aux luminaires degré K - *Intended for degré K medical lights* - Bestimmt für die degré K Leuchten:

- albédo N8R
- albédo Una

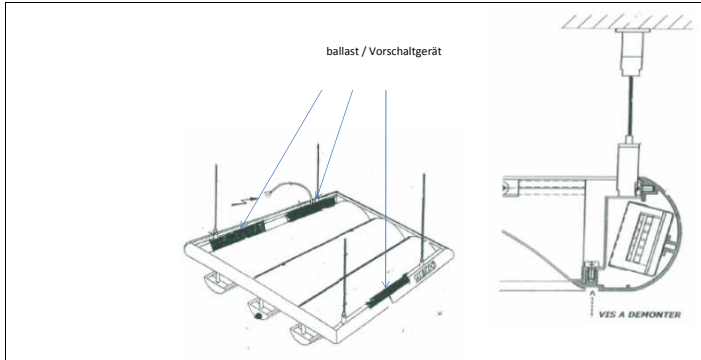


SCHEMA DE CABLAGE / WIRING DIAGRAM /

Nom du lum. The light name Leuchten- bezeichnung	Qté de ce ballast par lum. Number of this EB per light Anzahl dieses VG pro Leuchte	SCHEMA DU BALLAST : BAL_254_R2 DIAGRAM OF ELECTRONIC BALLAST SCHEMA DES ELECTRONISCHEN VORSCHALGERÄT HF-R 254 TL5 EII 220-240
ALBEDO N8R	2	
ALBEDO UNA	3	

Ballast Osram non-réglable QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP-DL 2x 55 GII - commande 2 tubes PLL 55 W.
Electronic ballast Osram non-regulated QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP-DL 2x 55 GII - drives 2 fluorescent lamps PLL 55 W.
Elektronisches Vorschaltgerät Osram nicht regelbar/einstellbar QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP-DL 2x 55 GII - betätigt 2 Röhren PLL 55 W.

Destiné au luminaire degré K - *Intended for degré K medical light* - Bestimmt für die degré K Leuchte:
- albédo MKIII



Branchement du nouveau ballast :

- 21 - fil violet
- 22 - fil vert
- 23 - fil blanc
- 24 - fil blanc
- 25 - fil gris
- 26 - fil gris

Un pont était fait entre les deux douilles avec le fil marron et était ensuite envoyé en position 1.

Le pont reste mais il n'est plus nécessaire de brancher le fil marron au ballast.

Ballast Philips réglable HF-REGULATOR : HF-R 255 PLL EII 220-240 - commande 2 tubes PLL 55 W.
Electronic ballast Philips regulated HF-REGULATOR: HF-R 255 PLL EII 220-240 - drives 2 fluorescent lamps PLL 55 W.
Elektronisches Vorschaltgerät Philips regelbar HF-REGULATOR: HF-R 255 PLL EII 220-240 - betätigt 2 Röhren PLL 55 W.

Destiné au luminaire degré K - *Intended for degré K medical light* - Bestimmt für die degré K Leuchte:

- albédo IIR

